



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen, Saksa
Sähköposti: info@kern-
sohn.com

Puh.: +49-[0]7433-9933-0
Faksi: +49-[0]7433-9933-149
Kotisivu: www.kern-sohn.com

Käyttöohje Henkilövaa'at BMI-toiminolla

KERN MPE

MPE 250K100HNM
MPE 250K100PNM
MPE 200K-1HEM
MPE 200K-1PEM

Versio 5.2
2018-11
FIN



MPE_HM / MPE_PM-BA-fin-1852

D	Weitere Sprachversionen finden Sie online unter www.kern-sohn.com/manuals
BG	Други езикови версии ще намерите в сайта www.kern-sohn.com/manuals
DK	Flere sprogudgaver findes på websiden www.kern-sohn.com/manuals
EST	Muud keeleversioonid leiate Te leheküljel www.kern-sohn.com/manuals
E	Más versiones de idiomas se encuentran online bajo www.kern-sohn.com/manuals
GR	Άλλες γλωσσικές αποδόσεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.kern-sohn.com/manuals
F	Vous trouverez d'autres versions de langue online sous www.kern-sohn.com/manuals
LV	Citas valodu versijas atradīsiet vietnē www.kern-sohn.com/manuals
FIN	Muut kieliversiot löytyvät osoitteesta www.kern-sohn.com/manuals
LT	Kitas kalbines versijas rasite svetainėje www.kern-sohn.com/manuals
GB	Further language versions you will find online under www.kern-sohn.com/manuals
RO	Alte versiuni lingvistice veți găti pe site-ul www.kern-sohn.com/manuals
I	Trovate altre versioni di lingue online in www.kern-sohn.com/manuals
SK	Iné jazykové verzie nájdete na stránke www.kern-sohn.com/manuals
NL	Bijkomende taalversies vindt u online op www.kern-sohn.com/manuals
SLO	Druge jezikovne različice na voljo na spletni strani www.kern-sohn.com/manuals
P	Encontram-se online mais versões de línguas em www.kern-sohn.com/manuals
CZ	Jiné jazykové verze najdete na stránkách www.kern-sohn.com/manuals
PL	Inne wersje językowe znajdą Państwo na stronie www.kern-sohn.com/manuals
SE	Övriga språkversioner finns här: www.kern-sohn.com/manuals
H	A további nyelvi változatok a következő oldalon található: www.kern-sohn.com/manuals
HR	Druge jezične verzije su dostupne na stranici: www.kern-sohn.com/manuals
NO	Andre språkversjoner finnes det på www.kern-sohn.com/manuals



KERN MPE

Versio 5.2 2018-11

Käyttöohje

Henkilövaa'at BMI-toiminolla

Sisällysluettelo

1	Tekniset tiedot.....	5
2	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	9
2.1	Lääkinnällisten tuotteiden merkinnän selite	9
3	Laitteiden rakenne.....	12
4	Näppäimistö.....	14
5	Lukemien rakenne.....	15
6	Perusohjeet.....	16
6.1	Käyttötarkoitus	16
6.2	Tarkoituksenmukainen käyttö.....	16
6.3	Epätarkoituksenmukainen käyttö	17
6.4	Takuu.....	17
6.5	Tarkastustoimenpiteet.....	17
7	Perusturvallisuusohjeet.....	18
7.1	Käyttöohjeen noudattaminen.....	18
7.2	Henkilöstön kouluttaminen	18
7.3	Saastutuksen (tartunnan) välttäminen	18
7.4	Oikea käyttö.....	18
8	Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC).....	19
8.1	Yleistä	19
8.2	Sähkömagneettiset päästöt.....	20
8.3	Sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys.....	21
8.3.1	Perustoimintaparametrit	23
8.4	Turvavälit	24
9	Kuljetus ja varastointi	25
9.1	Vastaanottotarkastus	25
9.2	Pakkaus/palautus.....	25
10	Pakkauksesta purkaminen, asettaminen ja käynnistäminen	26
10.1	Asennuspaikka, käyttöpaikka	26
10.2	Pakkauksesta purkaminen	26
10.3	Toimituksen sisältö	27
10.3.1	MPE-HM, MPE-PM -mallisto.....	27
10.3.2	MPE-HEM, MPE-PEM -mallisto	27
10.4	Vaa'an asennus ja asettaminen	27
10.5	Sähkökytkentä (MPE-NM-mallisto).....	28
10.6	Akkukäyttöinen toiminta on mahdollinen lisävarusteisella akulla	29
10.7	Paristokäyttöinen toiminta	30
10.8	Käyttöönotto.....	31
11	Käyttö	32
11.1	Punnitus.....	32

11.2	Taaraus	33
11.2.1	Taaran seuranta	34
11.3	HOLD-toiminto	34
11.4	Toisen desimaaliarvon näyttäminen	34
11.5	Painoindeksin laskenta (Body Mass Indexi)	35
11.5.1	Pituusmittaus (vain MPE-HM , MPE-HEM -mallit)	35
11.5.2	Painoindeksin laskenta (Body Mass Indexi)	36
11.5.3	BMI-arvon luokitus	37
11.6	Automaattinen sammutus	38
11.7	Näytön taustavalo	39
12	Valikko.....	40
12.1	Valikonavigointi	40
12.2	Valikon rakenne	41
13	RS 232-tiedonsiirtoliitäntä	44
13.1	Vaa'an lähtöliitännän napatoiminnot.....	44
13.2	Tekniset tiedot	44
13.3	Tulostustila.....	45
14	Virheilmoitukset	46
15	Huolto, kunnossapito, hävitys	47
15.1	Puhdistus	47
15.2	Puhdistus/desinfiointi	47
15.3	Sterilointi	47
15.4	Huolto, kunnossapito	47
15.5	Hävitys	47
16	Vianetsintä	48
17	Vakaus.....	49
17.1	Vakauksen voimassaoloaika (nykytila Saksassa).....	51
18	Kalibrointi	52

1 Tekniset tiedot

KERN (Tyyppi)	MPE 250K100HNM	MPE 250K100PNM
Malli	MPE 250K100HM	MPE 250K100PM
Ilmaisin	6-merkkinen	
Punnitusalue (max.)	250 kg	
Minimi kuormitus (minimi)	2 kg	
Vakaustaasteikko (e)	100 g	
Toistuvuus	0,1 kg	
Lineaarisuus ±	0,1 kg	
Näyttö	LCD-näyttö, lukukorkeus 25 mm	
Suosittelut kalibrointipaino (luokka)	>200 kg (M1)	
Signaalin nousuaika (tavallinen) (tyypillinen)	3 s	
Lämpenemisaika	10 min.	
Käyttölämpötila	+0°C +40°C	
Ilman kosteus	max. 80% (ei kondensointia)	
Virransyöttö	ottojännite 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz	
Automaattinen sammutus	3 minuutin kuluttua kuorman viimeisestä muutoksesta lukien (asetettavissa)	
Paino (lxsxk) mm	365 x 570 x 2134	365 x 570 x 1030
Vaa'an levy (mm)	365 x 360 x 80	
Paino kg (netto)	11.5	10.8
Vakaus direktiivin 2014/31/EU - mukaisesti	III luokka	
Lääkintätuote direktiivin 93/42/ETY - mukaisesti	I luokka, mittaustoiminnolla (Im)	
Pituusmittauksen asteikko sisäänrakennettu jalustaan, irrotettavissa (88cm - 205 cm)	✓	—

Akkukäyttöinen toiminta	lisävaruste; 6 x 1.2 VAA = 7.2 V/2000 mA
Paristot	6 x 1.5 V AA
Tiedonsiirtoliitäntä, vakiovarustus	RS 232 C

KERN (Tyyppi)	TMPE 250K-1HEM-A	TMPE 250K-1PEM-A
Malli	MPE 250K-100HEM	MPE 250K-1PEM
Ilmaisin	6-merkkinen	
Punnitusalue (max.)	250 kg	
Minimi kuormitus (minimi)	2 kg	
Vakausteikko (e)	100 g	
Toistuvuus	0,1 kg	
Lineaarisuus ±	0,1 kg	
Näyttö	LCD-näyttö, lukukorkeus 25 mm	
Suosittelun kalibrointipaino (luokka)	>200 kg (M1)	
Signaalin nousuaika (tavallinen) (tyypillinen)	3 s	
Lämpenemisaika	10 min.	
Käyttölämpötila	+0°C +40°C	
Ilman kosteus	max. 80% (ei kondensointia)	
Virransyöttö	ottojännite 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz (Virtalähde valinnainen)	
Automaattinen sammutus	3 minuutin kuluttua kuorman viimeisestä muutoksesta lukien (asetettavissa)	
Paino (lxsxk) mm	365 x 570 x 2134	365 x 570 x 1030
Vaa'an levy (mm)	365 x 360 x 80	
Paino kg (netto)	11.5	10.8
Vakaustas direktiivin 2014/31/EU - mukaisesti	III luokka	
Lääkintätuote direktiivin 93/42/ETY - mukaisesti	I luokka, mittaustoiminnolla (Im)	
Pituusmittauksen asteikko sisäänrakennettu jalustaan, irrotettavissa (88cm - 205 cm)	✓	—

Akkukäyttöinen toiminta	lisävaruste; 6 x 1.2 VAA = 7.2 V/2000 mA
Paristot	6 x 1.5 V AA
Tiedonsiirtoliitäntä, vakiovarustus	RS 232 C

2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Meidän voimassaoleva EY/EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksemme on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

www.kern-sohn.com/ce



Kalibroitavan (= standardinmukaiseksi todistetun) vaa'an vaatimustenmukaisuusvakuutus toimitetaan laitteen kanssa.

Ainoastaan tällaiset vaa'at ovat lääkinällisiä tuotteita.

2.1 Lääkinällisten tuotteiden merkinnän selite



Kaikki lääkinälliset vaa'at tällä merkinnällä täyttävät seuraavien direktiivien määräyksiä:

1. 2014/31/EU: Direktiivi muista kuin automaattisten vaa'ista
2. 93/42/EY: Direktiivi lääkinällisistä laitteista



Tällä merkillä merkityt vaa'at soveltuvat direktiivin 2014/31/EU:n mukaiseen III tarkkuusluokan vaatimuksenmukaisuusarviointiin.

WF 170012

Jokaisen laitteen eränumero merkitty laitteeseen ja pakkaukseen.

(kuvakkeessa esimerkillinen numero)



2018-11

Lääkintätuotteen valmistuspäivämäärän merkintä.

(esimerkillinen vuosi ja kuukausi)



"Huom., noudata oheisen asiakirjan määräyksiä",
tai "Noudata käyttöohjeen määräyksiä".



"Noudata käyttöohjeen määräyksiä".



"Noudata käyttöohjeen määräyksiä".




Lääkintätuotteen valmistajan nimi ja osoite.

Kern & Sohn GmbH
D-72336 Balingen,
Saksa
www.kern-sohn.com



"Lääkinnällinen sähkötuote"
B-tyyppisellä käyttöosalla.




II-suojaluokka.



Kuluneet laitteet eivät ole talousjätteitä!

Niitä on luovutettava talousjätteiden keräyspisteisiin.



12 V DC, 500 mA

Vaa'an syöttöjännite- ja napaisuustiedot.



Sähköliitäntä




KERN SEAL –sinetöinti



Tasavirta





Opastus



Vaaitse vaaka ennen käyttöä


3 Laitteiden rakenne

 <p>A front view of a white industrial platform scale. It has a vertical column with a horizontal beam at the top. A digital display is mounted on the column. The base is a flat platform. Numbered labels point to: 1. The height measurement scale on the beam; 2. The digital display; 3. The weighing platform; 4. The rubber feet at the base.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pituusmittauksen asteikko (vain MPE-HM -mallit)2. Näyttö3. Vaa'an levy (liukumaton pinta)4. Kumijalakset (korkeuden säädöllä)
<p>Alaosa (alapuoli)</p>  <p>A bottom view of the scale's platform. It shows four black casters (wheels) at the corners. A central rectangular area contains a small logo. Numbered label 5 points to the mounting bracket for the casters.</p>	<ol style="list-style-type: none">5. Rullat

Toisen näytön takapuoli





Näytön takapuoli

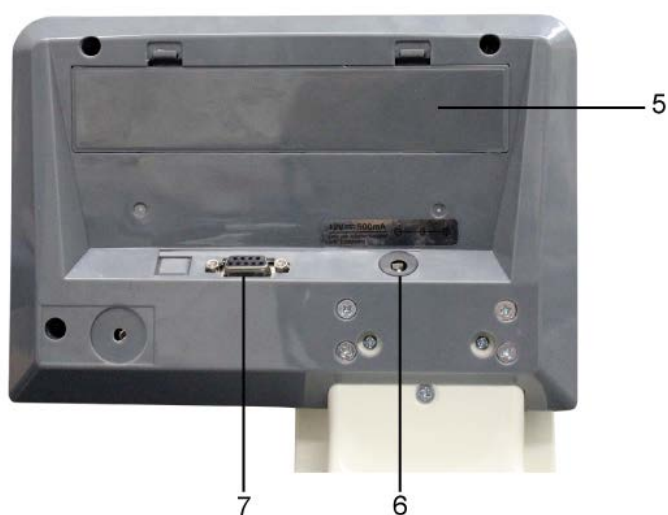





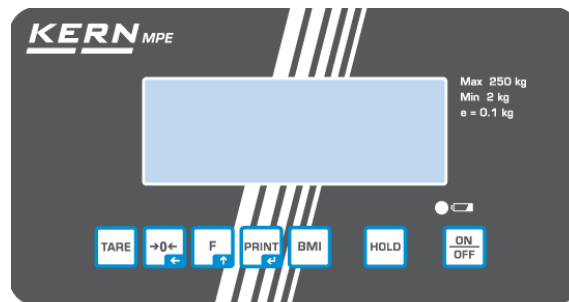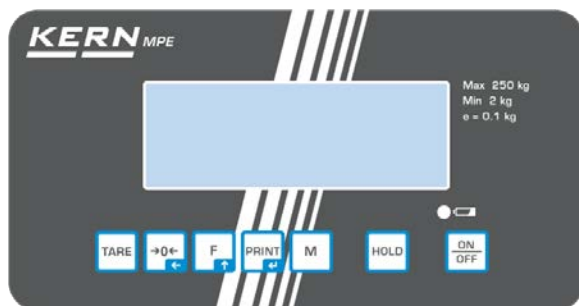


- 5 Akkutila
- 6 Virtaliitäntä (MPE-NM)
- 7 RS 232 C -liitäntä




4 Näppäimistö



Tyyppi MPE 250K100HNM
 Tyyppi MPE 250K100PNM
 Tyyppi TMPE 250K-1HEM-A
 Tyyppi TMPE 250K-1PEM-A

Painike	Nimi	Toiminto
	ON/OFF-painike	Käynnistys/sammutus
	HOLD-painike	HOLD-toiminto / punnitusarvon pitäminen
	BMI-painike	Painoindeksin merkintä (Body Mass Index)
	PRINT-painike	Tiedonsiirto liitännän kautta Valikossa: <ul style="list-style-type: none"> Valinnan vahvistaminen Numeerisen syötön yhteydessä: <ul style="list-style-type: none"> Numeroarvon vahvistaminen
	Valintapainike	Valikossa: <ul style="list-style-type: none"> Valikon avaaminen Valikon kohdan valinta Numeerisen syötön yhteydessä: <ul style="list-style-type: none"> Numeroarvon suurentaminen
	Nollauspainike	Vaa'an nollaus (vaaka näyttää 0.0) Numeerisen syötön yhteydessä: <ul style="list-style-type: none"> Desimaalipisteen aseman vaihto
	TARE-painike	Vaa'an taaraus

5 Lukemien rakenne

Lukema	Nimi	Kuvaus
	Stabiloinnin ilmainen	Vaaka on stabiili.
	Nolla-arvon ilmainen	Jos vaaka ei näytä nolla-arvoa, kun sen päällä ei ole kuormaa, paina  -painiketta. Tällöin vaaka nollautuu hetken kuluttua.
NET	Nettopainon ilmainen	Palaa nettopainoa näytettäessä. Palaa vaa'an taarauksen jälkeen.
GROSS	Bruttopainon ilmainen	Palaa bruttopainoa näytettäessä.
HOLD	HOLD-toiminto	HOLD-toiminto aktiivinen.
BMI	BMI-toiminto	Palaa BMI-toiminnon ollessa päällä.

6 Perusohjeet



2014/31/EY -direktiivin mukaisesti vaaka on aina vaattava seuraaviin käyttötarkoituksiin: 1 artikla, 2 momentti, iv kohta "Massan määrittäminen sairaanhoidossa potilaiden punnitsemiseksi heidän tilansa seurantaan, sairauden määrittämistä ja hoitoa varten".

6.1 Käyttötarkoitus

- Lukema**
- Kehon painon merkintä terveydenhoidossa.
 - Käytettävä "ei itsetoimivana vaakana", eli punnittava henkilö on varovasti asetettava vaakalevyn keskelle. Painoarvo voidaan lukea lukeman vakiintuessa.

- Vasta-aiheet**
- Ei tunnettuja vasta-aiheita.

6.2 Tarkoituksenmukainen käyttö

Vaaka on tarkoitettu seisovien henkilöiden painon määrittämiseen sairaanhoitotiloissa. Vaaka on tarkoitettu sairauksien tunnistamiseen, ehkäisyyn ja seurantaan.



Sarjaliitännällä varustetut vaa'at saa kytkeä ainoastaan EN 606011 -mukaisiin laitteisiin.

Henkilövaa'alla punnittava henkilö on asetettava varovasti vaakalevyn keskelle ja jätettävä seisomaan rauhallisesti.

Painoarvo voidaan lukea sen vakiintuessa.
Vaaka on suunniteltu jatkuvaa käyttöä varten.



Punnittavien henkilöiden tulee pystyä seisomaan molemmilla jaloillaan.

Vaakalevyt on varustettu liukumista estävällä pinnalla, jota ei saa poistaa punnitusajaksi.

Aina ennen käyttöä henkilöstön tulee varmistaa sen kunto.

6.3 Epätarkoituksenmukainen käyttö

Älä käytä vaakoja dynaamiseen punnitukseen.

Älä altista vaa'an punnituslevyä pitkäaikaiselle kuormitukselle. Se voi johtaa punnitusmekanismiin vaurioitumiseen.

Vältä ehdottomasti vaa'an punnituslevyn iskemistä ja ylikuormittamista yli suurimman nostokyvyn (taaralla vähennettynä). Ylikuormitus voi johtaa vaa'an vaurioitumiseen.

Älä koskaan käytä vaakaa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tuotteen vakiovarusteinen versio ei ole räjähdysturvallinen. Huomioi kuitenkin, että tulenarka seos voi muodostua myös happipitoisista tai ilokaasua (dityppioksidia) sisältävistä nukutusaineista.

Vaakaan ei saa tehdä rakennemuutoksia. Se voi aiheuttaa virheellisiä punnitustuloksia, teknisten turvallisuusvaatimusten rikkomisen ja vaa'an vaurioitumisen.

Vaakaa on käytettävä ainoastaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Muita käyttötarkoituksia/sovellutuksia varten on haettava KERN:n kirjallista lupaa.

6.4 Takuu

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

- käyttöohjeen määräyksien laiminlyönti;
- kuvatus käyttötarkoituksen vastainen käyttö;
- laitteen muuttaminen tai avaaminen;
- mekaaninen tai aineiden (esim. nesteiden) aiheuttama vaurioituminen;
- laitteen luonnollinen kuluminen;
- väärä säätö tai viallinen sähköasennus;
- mittausrakenteiden ylikuormittaminen.
- vaa'an putoaminen.



6.5 Tarkastustoimenpiteet

Laadunvalvontajärjestelmän puitteissa tulee tarkistaa määräajoin vaa'an mittaustoimintaa sekä mahdollisesti käytettävissä referenssipainon teknisiä ominaisuuksia. Tätä varten vastaavan henkilön tulee määrittää asianmukainen aikaväli sekä tarkastuksen tyyppi ja alue. Valvontalaitteisiin (eli myös vaakoihin) liittyvät tarkastusohjeet sekä tarvittavat referenssipainot löytyvät KERN:n verkkosivulta (www.kern-sohn.com). Referenssipainoja ja vaakoja voidaan kalibroida nopeasti ja edullisesti DKD:n (Deutsche Kalibrierdienst) valtuutetussa KERN:n kalibroitilaboratoriossa (tietystä maassa voimassaolevaan standardiin mukauttaminen).

Kehon pituuden mittausasteikolla varustettujen henkilövaakojen kohdalla suositellaan tarkistamaan asteikon tarkkuus, sillä ihmiskehon pituusmittauksiin liittyy aina suuri virheellisyysriski.

7 Perusturvallisuusohjeet

7.1 Käyttöohjeen noudattaminen

	⇒ Ennen vaa'an asettamista ja käynnistystä lue huolellisesti tämä käyttöohje, vaikka sinulla olisi jo kokemusta KERN-vaakojen käytöstä.	
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

7.2 Henkilöstön kouluttaminen

Tuotteen oikean käytön ja huollon varmistamiseksi sairaanhoitohenkilöstön tulee tutustua käyttöohjeeseen ja noudattaa sen määräyksiä.

7.3 Saastutuksen (tartunnan) välttäminen

Ristitartunnan (sienitauti, ...) välttämiseksi vaakalevy on puhdistettava säännöllisesti. Suositus: aina punnituksen jälkeen, jos siihen liittyy tartuntavaara (kun punnituksessa esiintyy esim. välitöntä ihokosketusta).

7.4 Oikea käyttö

- Astu henkilövaa'alle ja poistu siitä ainoastaan, kun mukanasasi on pätevä henkilö (katso kohta 7.2).
- Aina ennen käyttöä tarkista vaaka mahdollisten vaurioiden varalta.
- Huolto ja vakaus
Henkilövaakaa on huollettava ja vaattava säännöllisesti (katso kohta 15.4).

8 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

8.1 Yleistä



MPE -henkilövaakojen asennus- ja käyttöaikana on noudatettava erityisiä varotoimia alla olevien sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettujen tietojen mukaisesti.

Laitteparametrit vastaavat lääkinnällisen sähkölaitteen 1 ryhmän B-luokkaa (EN 60601-1-2 -mukaisesti).

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) tarkoittaa laitteen luotettavaa toimintakykyä sähkömagneettisessa ympäristössä ilman luvattomia sähkömagneettisia häiriöitä. Kyseiset häiriöt ovat välitettävissä liitäntäjohtojen tai ilman kautta.

Luvattomat ympäristöstä peräisin olevat häiriöt voivat aiheuttaa virheellisiä lukemia, epätarkkoja mittausravvoja tai MPE -henkilövaakojen virheellisen toiminnan. Vastaavasti tietyissä olosuhteissa MPE -vaa'at saattavat aiheuttaa samantyyppisiä häiriöitä muihin laitteisiin. Ongelmien ehkäisemiseksi suositellaan toimimaan tarpeiden mukaan seuraavasti:

- Vaihda laitteen asemointi tai turvaväli häiriölähteeseen nähden.
- Aseta tai käytä MPE henkilövaakaa muussa paikassa.
- Kytke MPE -henkilövaaka muuhun virtalähteeseen.
- Jos sinulla on edelleen kysyttävää, ota yhteyttä huoltopalveluumme.

Laitteen luvaton muuttaminen tai kehittäminen sekä ei-suositeltujen varusteiden käyttö (esim. virtalähde tai virtajohdot) voi aiheuttaa häiriöitä. Valmistaja ei ole vastuussa tällaisista häiriöistä. Lisäksi kyseiset muutokset voivat aiheuttaa laitteen käyttöluvan menettämisen.



MPE -henkilövaakojen häiriöt voivat aiheutua korkean taajuuden signaaleja lähettävien laitteiden käytöstä (matkapuhelimet, radiolähetimet, radiovastaanottimet). Tämän vuoksi niiden käyttöä on vältettävä MPE -henkilövaakojen läheisyydessä. Luvussa 8.4 annettiin tietoa suositeltavista minimiväleistä.

8.2 Sähkömagneettiset päästöt

Valmistajan ohjeet ja lausunto - sähkömagneettiset häiriöt		
MPE -henkilövaa'at ovat tarkoitettu toimimaan yhdessä alla mainituista sähkömagneettisista ympäristöistä. MPE -henkilövaa'an ostajan tai käyttäjän tulee varmistaa, että vaakaa käytetään juuri kyseisessä ympäristössä.		
Häiriöiden mittaukset	Vaatimustenmukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet:
Korkean taajuuden päästöt CISPR 11/EN 55011 - mukaisesti	Ryhmä 1	MPE -henkilövaa'at hyödyntävät korkeita taajuuksia ainoastaan sisätoimintoihinsa. Näin ollen korkeiden taajuuksien päästöt ovat hyvin matalia ja häiriöiden aiheuttaminen lähellä oleviin sähkömagneettisiin laitteisiin on poissuljettu.
Korkean taajuuden päästöt CISPR 11/EN 55011 - mukaisesti	B-luokka	MPE -henkilövaakoja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa laitteissa, joita käytetään ainoastaan asuinympäristössä, liitettynä välittömästi julkiseen sähköverkkoon, josta myös syötetään virtaa asuinrakennuksiin.
Huiluäänien päästöt IEC 6100032 -standardin mukaisesti	A-luokka	
Jännitteen vaihtelusta aiheutuvat häiriöt/vilkkuminen IEC 6100033 -standardin mukaisesti	Yhdenmukainen	


MPE -henkilövaakoja ei saa käyttää muiden laitteiden välittömässä läheisyydessä tai pinottuna muiden laitteiden päälle. Jos tällaisia käyttöolosuhteita ei kuitenkaan voida välttää, MPE -henkilövaa'an toimintaa on tarkkailtava ja tarkistettava sen oikeellisuus.

8.3 Sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys

Valmistajan ohjeet ja lausunto - sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys			
MPE -henkilövaa'at ovat tarkoitettu toimimaan yhdessä alla mainituista sähkömagneettisista ympäristöistä. MPE -henkilövaa'an ostajan tai käyttäjän tulee varmistaa, että vaakaa käytetään juuri kyseisessä ympäristössä.			
Häiriönkestävyyden tutkimukset	Viitearvot IEC 60601 -standardin mukaisesti	Vaatimusten mukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet:
Sähköstaattiset purkaukset (ESD) IEC 6100042 -standardin mukaisesti	± 6 kV, kosketuspurkaus ± 8 kV, ilmapurkaus	± 6 kV ± 8 kV	Lattian tulee olla puu- tai betonilattia tai päällystetty kaakeleilla. Jos lattia on tehty tekoaineesta, suhteellisen ilman kosteuden tulee olla vähintään 30%.
Nopeat ohimenevät sähköhäiriöt/väriin synkronointisignaalit IEC 6100044 -standardin mukaisesti	± 2 kV virtajohtojen osalta ± 1 kV otto- ja lähtöjohtojen osalta	± 2 kV ± 1 kV	Syöttöjännitteen laadun tulee olla tyypillisen kauppa- tai sairaalaympäristön mukainen.
Syöksyjännite IEC 6100045 -standardin mukaisesti	± 1 kV, jännite ulkojohto – ulkojohto ± 2 kV, jännite ulkojohto – maadoitus	± 1 kV Ei sovellettu.	Syöttöjännitteen laadun tulee olla tyypillisen kauppa- tai sairaalaympäristön mukainen.
Syöttöjännitteen kuopat, lyhyet katkokset tai vaihtelut IEC 61000411 -standardin mukaisesti	$<5\% U_T$ ($>95\%$ vähemmän U_T) 1/2 jakson osalta $40\% U_T$ ($>60\%$ vähemmän U_T) 5 jakson osalta $70\% U_T$ ($>30\%$ vähemmän U_T) 25 jakson osalta $<5\% U_T$ ($>95\%$ vähemmän U_T) 5s:n osalta	Vaatimukset pysyvät voimassa kaikkien ehtojen osalta. Valvottu sammutus. Paluu turvtilaan käyttäjän puuttumisen jälkeen.	Syöttöjännitteen laadun tulee olla tyypillisen kauppa- tai sairaalaympäristön mukainen. Jos MPE-henkilövaakojen käyttäjä edellyttää vaa'an jatkuvaa toimintaa myös sähkökatkosten yhteydessä, suosittelemme käyttämään keskeytymätöntä virransyöttöä tai akkua.
Magneettinen kenttä, jonka taajuus on syöttöjännitteen mukainen (50/60 Hz) IEC 6100048 -standardin mukaisesti	3 A/m	3 A/m 50/60 Hz	Sähköverkon taajuuden mukaisten magneettisten kenttien tulee vastata tyypillisiä kaupallisissa ja sairaalaympäristössä noudatettavia arvoja.
HUOM U_T tarkoittaa sähköverkon jännitettä ennen koetasoa käyttöä.			

Valmistajan ohjeet ja lausunto - sähkömagneettisten häiriöiden kestävyys

MPE -henkilövaat ovat tarkoitettu toimimaan yhdessä alla mainituista sähkömagneettisista ympäristöistä. MPE -henkilövaat ostajan tai käyttäjän tulee varmistaa, että vaakaa käytetään juuri kyseisessä ympäristössä.

Häiriönkestävyyden tutkimukset	Viitearvot IEC 60601 -standardin mukaisesti	Vaatimusten mukaisuus	Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet:
Korkean taajuuden johtohäiriöt IEC 6100046 -standardin mukaisesti	$3 V_{rms}$ 150 kHz-80 MHz	3 V	Kannettavia ja mobileja radiolaitteita johtoineen ei saa käyttää MPE -henkilövaakojen lähellä ja tällöin on pidettävä lähettimen käyttötaajuuden mukaan laskettua turvaväliä.
Lähetetyt korkean taajuuden häiriöt IEC 6100043 -standardin mukaisesti	$3 V_{rms}$ 80 MHz-2,5 GHz	3 V/m 	Suositeltu turvaväli: $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P}$ Taajuus 80 MHz-800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ Taajuus 800 MHz-2,5 GHz jossa „P” tarkoittaa lähettimen wattimääräistä (W) nimellistehoa ja „d” tarkoittaa suositeltua turvaväliä metreissä (m). Kiinteiden radiolähettimien kenttien voimakkuus kaikkien taajuuksien osalta tietyssä paikassa ^a tehdyn mittauksen mukaan tulee olla yhdenmukaisuusarvoa pienempi. ^b Alla olevalla merkillä merkityssä laiteympäristössä voi esiintyä häiriöitä.
HUOM 1 HUOM 2	80 MHz ja 800 MHz:n taajuuden osalta sovelletaan korkeampi taajuusalue. Ohjeet eivät ole sovellettavissa kaikkiin tapauksiin. Sähkömagneettisten häiriöiden levittämiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastukset.		

- ^a Kiinteiden lähettimien kenttien voimakkuutta, kuten esim. matkapuhelimien radioverkkojen tukiasemien, yksityisradioasemien, AM- ja FM-radiolähettimien ja televisiolähettimien, ei voi määritellä teoreettisesti etukäteen. Tarkempia tietoja kiinteiden lähettimien sähkömagneettisesta ympäristöstä voi saada tutkimalla kyseisen käyttöpaikan olosuhteita. Jos kentän mitattu paikallinen voimakkuus ylittää yllä mainittuja yhdenmukaisuustasoja, käytettävän MPE -henkilövaa'an toiminnan oikeellisuutta on valvottava. Poikkeavia toimintaparametreja havaittaessa voi olla tarpeen suorittaa lisätoimenpiteitä, esim. MPE -henkilövaa'an asetuksen tai sijainnin muuttaminen.
- ^b 150 kHz-80 MHz:n välisen taajuuden osalta kentän voimakkuuden ei tulisi ylittää 3 V/m.

8.3.1 Perustoimintaparametrit



MPE henkilövaa'at eivät täytä mitään IEC 606011 -standardissa määriteltyjä perustoimintaparametreja. Järjestelmää saattavat häiritä myös sellaiset laitteet, jotka täyttävät CISPR-standardin mukaisia lähetysvaatimuksia.

8.4 Turvavälit

Suosittelut turvavälit MPE-henkilövaakojen ja korkean taajuuden kannettavien ja mobiililaitteiden välillä

MPE -henkilövaaka'at ovat tarkoitettu toimimaan sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa on valvottu korkean taajuuden häiriöitä. MPE-henkilövaakojen ostaja tai käyttäjä voi välttyä sähkömagneettisilta häiriöiltä pitämällä minimiturvaväliä korkean taajuuden kannettaviin ja mobiileihin kaukoviestintälaitteisiin (lähettimiin) viestintälaitteen lähtötehon mukaisesti, kuten alla on eritelty.

Lähettimen nimellisteho W	Turvaväli lähettimen käyttötaajuuden mukaan m		
	150 kHz-80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz-800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz-2,5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,20	1,20	2,30
10	3,80	3,80	7,30
100	12,00	12,00	23,00

Jos kysymys on lähettimistä, joiden maksimi nimellisteho ei ole annettu yllä olevassa taulukossa, suositeltava d-turvaväli (m) voidaan määrittää vastaavassa sarakkeessa annetun yhtälön mukaisesti, jossa "P" tarkoittaa lähettimen suurinta wattimääräistä (W) nimellistehoa valmistajan antaman erittelyn mukaisesti.

HUOM 1 80 MHz ja 800 MHz:n taajuuden osalta sovelletaan korkeampi taajuusalue.
 HUOM 2 Ohjeet eivät ole sovellettavissa kaikkiin tapauksiin.
 Sähkömagneettisten häiriöiden levittämiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastukset.

9 Kuljetus ja varastointi

9.1 Vastaanottotarkastus

Paketin vastaanoton yhteydessä pakkausta ja laitetta on tarkistettava välittömästi sen mahdollisten vaurioiden kannalta - sama pätee laitteeseen, kun se on otettu pakkauksesta.

9.2 Pakkaus/palautus



- ⇒ Kaikki alkuperäisen pakkauksen osat on säilytettävä mahdollisen palautuslähetyksen varalta.
- ⇒ Vaa'an voi palauttaa vain alkuperäisessä pakkauksessa.
- ⇒ Ennen lähetystä irrota kaikki johdot ja löysät/liikkuvat osat.
- ⇒ Asenna takaisin kuljetussuojat, mikäli käytettävissä.
- ⇒ Kaikki osat, kuten esim. vaakalevy, virtalähde jne. on suojattava siirtymiseltä ja vaurioitumiselta.

10 Pakkauksesta purkaminen, asettaminen ja käynnistäminen

10.1 Asennuspaikka, käyttöpaikka

Vaaka on rakennettu siten, että normaaleissa käyttöolosuhteissa saatavat mittausarvot ovat luotettavat.

Oikean sijainnin valinta varmistaa vaa'an tarkan ja nopean toiminnan.

Asennuspaikan osalta noudata seuraavia sääntöjä:

- Aseta vaaka tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja lämpötilan vaihtelua, esim. lähellä olevien pattereiden tai auringonsäteilyn vuoksi.
- Suojaa vaakaa läpivedolta, joka aiheutuu auki olevista ikkunoista tai ovista.
- Vältä vaa'an ravistamista punnituksen yhteydessä.
- Suojaa vaakaa korkealta ilmastokosteudelta, höyryiltä ja pölyltä.
- Älä altista laitetta voimakkaalle ja pitkäaikaiselle kosteudelle. Kaste (ilmasta kondensoitunut kosteus) voi muodostua silloin, kun kylmä laite sijoitetaan huomattavan lämpimämpään tilaan. Tällöin sähköverkosta katkaistu laite on ensin mukautettava ympäristön lämpötilaan n. 2 tunnin ajan.
- Vältä vaa'an ja punnittavien henkilöiden staattista lataamista.
- Vältä kastumista.

Mikäli ympäristössä on olemassa sähkömagneettisia kenttiä (esim. GSM-verkkoja tai radiolaitteita), staattisia kuormia tai epästabiilia virransyöttöä, suuri lukeman poikkeama (väärä punnitustulos) on mahdollinen. Tällöin on muutettava vaa'an sijaintia tai poistettava häiriöiden lähde.

10.2 Pakkauksesta purkaminen

Ota vaa'an osa tai koko vaaka varovasti pakkauksesta ja aseta se käyttöpaikkaansa. Käyttäessäsi virtalähdettä huomioi, ettei virtajohto estä liikkumista ja aiheuta vaaratilanteita.

10.3 Toimituksen sisältö

10.3.1 MPE-HM, MPE-PM -mallisto

- Paino
- Virtalähde (EN 606011 -mukainen)
- Käyttöohje

10.3.2 MPE-HEM, MPE-PEM -mallisto

- Vaaka jalustalla
- Akut 6 x AA 1,5 V
- Käyttöohje


10.4 Vaa'an asennus ja asettaminen

Asennus:


⇒ Asenna jalusta (1)
vaakalevyrungossa oleviin
uriin (2).




Vältä johdon (3)
puristamista!

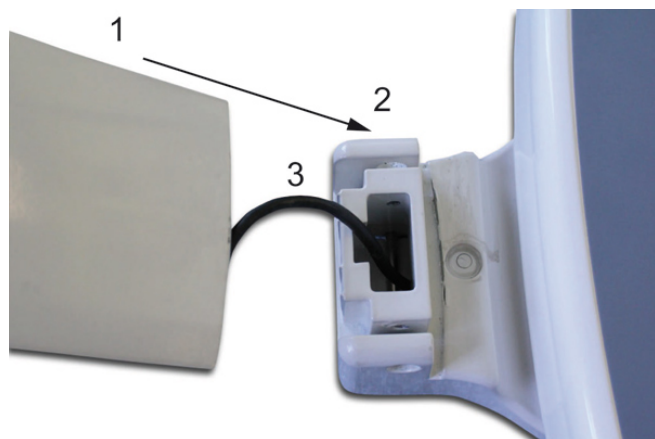

⇒ Kiinnitä pidike 4 pultilla.

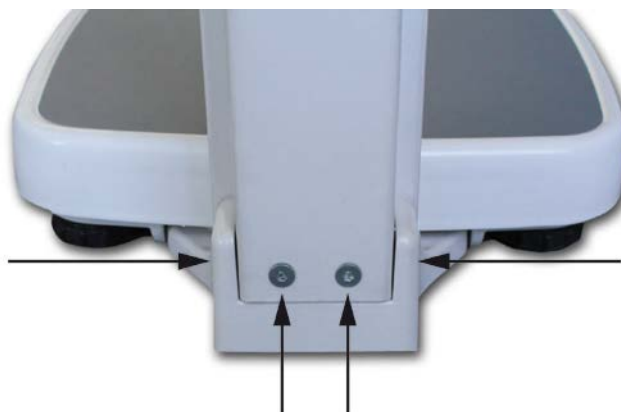



- ⇒ Tasapainota vaaka pulttijalaksilla. Vesivaa'an ilmakuplan tulee sijaita merkityllä alueella.
- ⇒ Tarkista vaa'an tasapainotus säännöllisesti.

10.5 Sähkökytkentä (MPE-NM-mallisto)

Virransyötöstä vastaa ulkopuolinen virtalähde, joka toimii myös sähköverkon ja vaa'an eristimenä. Paikallisen sähköverkon jännitteen tulee olla laitteeseen painetun arvon mukainen.

Käytä ainoastaan hyväksytyjä alkuperäisiä KERN-merkkisiä EN 606011 -mukaisia virtalähteitä.

Näytön kyljessä oleva pieni tarra viittaa sähköliitintään:




Jos vaaka on kytketty sähköverkkoon, LED-diodi palaa. Latausaikana LED-ilmaisimella ilmoitetaan akun lataustason.


vihreä: Akku on täysin ladattu.

sininen: Akkua ladataan.

10.6 Akkukäyttöinen toiminta on mahdollinen lisävarusteisella akulla

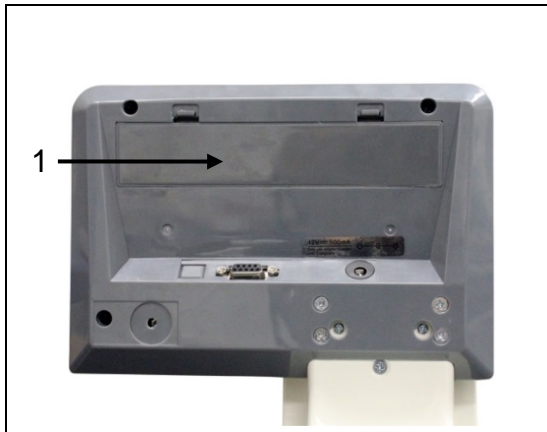

Avaa akkutilan kansi (1) näytön alapuolelta ja kytke akku. Ennen käyttöönottoa akkua on ladattava vähintään 12 tunnin ajan.

Jos näytölle ilmestyy -merkki, se tarkoittaa akun virran loppuvan pian. Vaaka voi toimia vielä pari minuuttia, jonka jälkeen se sammuu automaattisesti säästääkseen akkua. (11.6 Auto off). Lataa akku.



Jännite on laskenut suositellun minimiarvon alle.



Akun virta pian loppuu.



Akku on täysin ladattu.

Jos vaaka on poissa käytöstä pidemmän ajan, akku on poistettava laitteesta ja varastoitava erillään. Vuotava elektrolyytti voi johtaa vaa'an vaurioitumiseen.

10.7 Paristokäyttöinen toiminta

Vaihtoehtona akkukäyttöiselle toiminnalle, vaaka on käytettävissä paristoilla (6 kpl AA-paristoa).

Avaa akkutilan kansi (1) näytön alapuolelta ja asenna paristot alla esitetyllä tavalla. Aseta akkutilan kansi takaisin paikalleen. Kun paristot ovat heikot, näytölle ilmestyy



-merkki. Tällöin paristot on vaihdettava. Paristojen säästämiseksi vaaka sammuu automaattisesti (katso kohta 11.6, Auto Off -toiminto).



Paristot tyhjä



Paristojen virta pian loppuu



Paristot ovat täysin ladattu

Paristojen asennus:

Poista akkutilan kansi.	
Kytke paristorasia liittimeen kuvan mukaisesti.	
Asenna paristorasia.	
Aseta paristot ja lukitse kansi takaisin paikalleen.	

10.8 Käyttöönotto

Sähkövaakojen punnitustarkkuuden varmistamiseksi on niitä käytettävä asianmukaisessa käyttölämpötilassa (katso luku 1 "Lämpenemisaika"). Lämpenemisaikana vaa'an tulee olla kytketty sähköverkkoon (pistorasiasta, akusta tai paristosta) ja olla päällä.

Vaa'an punnitustarkkuus riippuu paikallisesta gravitaatiokiihtyvyydestä. Painovoiman kiihtyvyyssarvo on annettu tyyppikilvessä.

11 Käyttö

11.1 Punnitus




Kytke vaaka päälle -painikkeella.

Vaaka suorittaa käynnistystarkistuksen.

Laite on käyttövalmis heti kun näytölle tulee "0.0 kg".



▪ -painikkeella voit milloin tahansa nollata vaa'an tarvittaessa.



Aseta punnittava henkilö vaakalevyn keskelle. Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy sekä lue punnitustulos.



▪ Jos punnittava henkilön paino ylittää punnitusalueen, näytölle tulee „OL” (= ylikuormitus).


11.2 Taaraus


Punnituksessa käytettävän esikuorman paino (taara) voidaan asettaa painamalla vastaavaa painiketta, jonka perusteella seuraavien punnitusten yhteydessä saadaan henkilön todellinen paino.



⇒ Aseta esine (esim. pyyhe tai matto) vaakalevyn päälle.




⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee nolla. Näytön vasempaan alanurkkaan ilmestyy NET-merkki.



⇒ Aseta punnittava henkilö vaakalevyn keskelle. Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy sekä lue punnitustulos.




- Jos vaaka on kuormittamaton, tallennettu taara-arvo näytetään miinuksella.
- Taara-arvon nollaamiseksi poista nosturivaa'asta kuorma ja paina -painiketta.


11.2.1 Taaran seuranta


Vaaka voidaan taarata useampi kerta.


11.3 HOLD-toiminto

Vaaka on varustettu pidätystoiminnolla (keskiarvon määrittäminen). Näin punnitusarvo voi olla tarkka myös henkilöiden liikkuesssa vaakalevyllä seisoen.




⇒ Kytke vaaka päälle -painikkeella. Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy.



⇒ Paina -painiketta, jolloin näytölle tulee „-----” ja HOLD-merkki.


⇒ Aseta punnittava henkilö vaakalevyn keskelle.



(esimerkki)

⇒ Hetken kuluttua ilmestyy STABLE-stabilointi-ilmais ja henkilön painoarvo, joka ”jäädyytetään”.

Kun henkilö poistuu vaa’alta, painoarvo näkyy vielä noin 10 sekunnin ajan ja sitten vaaka siirtyy automaattisesti punnitustilaan.
HOLD-merkki sammuu.



Keskiarvo ei määrydy, jos punnittava henkilö liikkuu liikaa.

11.4 Toisen desimaaliarvon näyttäminen

Kun painoarvo on näkyvillä, paina -painiketta ja pidä sitä alhaalla noin 2 sekuntia. Tällöin n. 5 sekunnin ajan näytetään toista desimaaliarvoa.

11.5 Painoindeksin laskenta (Body Mass Index)

BMI-arvon laskemiseksi tarvitaan tieto kyseisen henkilön pituudesta. Potilaan pituus on tarkistettava asiakirjoista tai MPE-HM , MPE-HEM -mallin kohdalla se voi mitata vaa'an avulla.

11.5.1 Pituusmittaus (vain MPE-HM , MPE-HEM -mallit)



- ⇒ Vedä asteikko ylöspäin ja aseta mittausrauta vaakasuoraan.
- ⇒ Siirrä asteikkoa varovasti alaspäin, kunnes mittausrauta koskee henkilön päätä (mittaus suositellaan suorittamaan ilman kenkiä).




Jos mittausrauta jää pistämään esiin, voi se aiheuttaa loukkaantumisvaaran.




⇒ Lue pituusarvo asteikosta.


11.5.2 Painoindeksin laskenta (Body Mass Indexi)




⇒ Kytke vaaka päälle -painikkeella.


⇒ Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy.




⇒ Paina .
Näytölle tulee viimeksi syötetty pituus, aktiivinen arvo vilkkuu. BMI-merkki palaa.



⇒ Syötä pituus  ja -painikkeilla.





⇒ Vahvista asetettu arvo painamalla . Näytölle tulee BMI-arvo "0.0".



⇒ Aseta punnittava henkilö vaakalevyn keskelle.
Näytölle ilmestyy hetkeksi „-----”-merkki ja sitten henkilön BMI-arvo.

⇒ Poista vaakalevyn kuormitus.



⇒ Voit palata punnitustoimintoon painamalla .
BMI-merkki sammuu, näytöltä ilmenee "kg".



- Luotettava BMI-tulos on saatavilla vain 100-200cm:n pituudella ja >10 kg:n painolla.
- Jos punnittava henkilö liikkuu vaa'alla istuessaan, voi punnitusarvon stabiloida Hold-toiminnon avulla.


11.5.3 BMI-arvon luokitus


Aikuisten BMI-luokitus WHO:n 2000 EK IV ja WHO 2004 -standardin mukaan (Maailman terveysjärjestö).

Luokka	BMI (kg/m ²)	Obesiteettiin liittyvä sairausriski
Alapaino	<18,5	matala
Normaali paino	18,5–24,9	tavallinen
Ylipaino	≥25,0	
Esiobesiteetti	25,0–29,9	vähän korkeampi
I obesiteetin aste	30,0–34,9	korkeampi
II obesiteetin aste	35,0–39,9	korkea
III obesiteetin aste	≥40	erittäin korkea


11.6 Automaattinen sammutus

Jos näyttöön tai vaakalevyn ei kosketa, vaaka sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.

- 
- Valikon asetukset:
[F1 oFF] ⇒ [oFF 0/3/5/15/30] (katso 12 luku)





(esimerkki)



(esimerkki)


⇒ Punnitustilassa paina -painiketta, jolloin näytölle tulee ensimmäinen toiminto **[F1 oFF]**.

⇒ Paina , jolloin laite näyttää viimeksi tallennetun ajan, esim. **[oFF 15]**.

⇒ Paina -painiketta uudelleen, kunnes asetat tarvittavan ajan, esim. **[oFF 30]**.

[oFF 0]	AUTO OFF -toiminto deaktivoitu.
[oFF 3]	Punnitusjärjestelmä sammuu 3 minuutin kuluttua.
[oFF 5]	Punnitusjärjestelmä sammuu 5 minuutin kuluttua.
[oFF 15]	Punnitusjärjestelmä sammuu 15 minuutin kuluttua.
[oFF 30]	Punnitusjärjestelmä sammuu 30 minuutin kuluttua.



⇒ Tallenna valittu aika painamalla , jolloin toiminto **[F1 oFF]** ilmestyy.





⇒ Voit palata punnitustoimintoon painamalla -painiketta.

11.7 Näytön taustavalo




- Valikon asetukset:
[F4 bk] ⇒ [bL on/bL oFF/bL AU] (katso 12 luku)




(esimerkki)



⇒ Punnitustilassa paina -painiketta, jolloin näytölle tulee ensimmäinen toiminto [F1 oFF].

⇒ Paina -painiketta uudelleen, kunnes näytölle tulee toiminto [F4 bk].


⇒ Paina , jolloin laite näyttää viimeksi tallennetun asetuksen, esim. [bL on].


⇒ Valitse haluttu asetus -painikkeella.

bL on Taustavalo jatkuvasti päällä.

bL off Taustavalo pois päältä.

bL Auto Taustavalo kytkeytyy automaattisesti päälle vaakaa kuormitettaessa tai painiketta painettaessa.



⇒ Tallenna valittu aika painamalla , jolloin toiminto [F4 bK] ilmestyy.



⇒ Voit palata punnitustoimintoon painamalla -painiketta.

12 Valikko









Lainmukaisten vaakojen osalta pääsy ”tCH”-huoltovalikkoon on estetty.

Lukituksen poistamiseksi sinetöinti on poistettava ja painettava kalibroitipainiketta. Kalibroitipainikkeen sijainti - katso 18 luku.





Huom:





Sinetöinnin poiston jälkeen ja ennen punnitusjärjestelmän käyttöä lainmukaisiin tarkoituksiin se on vaattava uudelleen pätevässä hyväksyntälaitoksessa ja sinetöitävä uudelleen.

12.1 Valikkonavigointi

Valikon avaaminen	⇒ Punnitustilassa paina  -painiketta, jolloin näytölle tulee ensimmäinen toiminto [F1 OFF] .
Toiminnon valinta	⇒ Painikkeella  voit vaihtaa toimintoja.
Asetusten muuttaminen	⇒ Vahvista valittu toiminto painamalla  . Näytölle tulee toiminnon tämänhetkinen asetus. ⇒ Valitse tarvittava asetus painamalla  -painiketta ja vahvista painamalla  , jolloin vaaka siirtyy takaisin valikkoon.
Valikosta poistuminen/ paluu punnitustilaan	⇒ Paina  -painiketta, jolloin vaaka palaa punnitustilaan.

12.2 Valikon rakenne

Valikkolohko Päävalikko	Valikon kohta Alivalikko	Asetukset/selite
<div>F1 oFF</div> <div>Automaattinen sammutus „auto Off”- toiminto</div>	oFF 0*	Automaattinen sammutus kytketty pois päältä.
	oFF 3	Automaattinen sammutus 3 min. kuluttua
	oFF 5	Automaattinen sammutus 5 min. kuluttua
	oFF 15	Automaattinen sammutus 15 min. kuluttua
	oFF 30	Automaattinen sammutus 30 min. kuluttua
<div>F2 SUB</div>	oFF*	Ei eritelty.
	Prt	
	Pr ACC	
<div>F3 Prt</div> <div>Liitântäparametrit</div>	1. RS232-tila	
	Valitse haluttu tila painamalla  ja vahvista se  -painikkeella.	
	P Prt	Painoarvo lisätään summausmuistiin ja tulostetaan PRINT-painiketta painettaessa.
	P Cont	Tietojen jatkuva tulostus.
	Erät	Ei eritelty.
	ASK	Kauko-ohjauskomennot: W: Lähettää jokaisen painoarvon. S: Lähettää stabiilin painoarvon. T: Taaraus. Z: Nollaus.
	P cnt 2	Ei eritelty.
	P Stab	Automaattinen stabiilin punnitusarvon tulostus.
	P Auto	Painoarvo lisätään summausmuistiin ja tulostetaan.
	2. Tiedonsiirtonopeus	
Kun RS232-tila on vahvistettu, näytölle tulee asetettu tiedonsiirtonopeus (b xxxx). Valitse haluttu tiedonsiirtonopeus painamalla  ja vahvista  -painikkeella. Tiedonsiirtonopeus, vaihtoehdot 600, 1200, 2400, 4800, 9600.		


<div>3. Tietojen tulostusmuoto</div> <div>(vain jos käytössä on asetus P Prt, P Auto, P Cont)</div> <div>Kun tiedonsiirtonopeus on vahvistettu, näytölle tulee aktiivinen tulostemuoto. Valitse haluttu muoto painamalla  ja vahvista -painikkeella.</div>				
vain jos käytössä on asetus	Prt 0–3	Tietojen tulostusmuoto, katso kohta 13.		
	vain jos käytössä on asetus P Cont	Cont 1	Vakioasetus.	Sd0 – on/off Jatkuva tiedonsiirto, valinta „lähetä 0“, kyllä / ei
		Cont 2	Ei eritelty.	
		Cont 3	Ei eritelty.	
<div>4. Tulostimen tyyppi</div> <div>Kun tulostemuoto on vahvistettu, näytölle tulee aktiivinen tulostimen tyyppi.</div> <div>Valitse haluttu tulostimen tyyppi painamalla  ja vahvista se -painikkeella.</div> <div>LP-50 Ei eritelty.</div> <div>tPUP Käytä tätä asetusta</div>				
<div><div>F4 bl</div><div>Ilmaisimen taustavalo</div></div>	bl on	Ilmaisimen taustavalopäällä.		
	bl oFF	Ilmaisimen taustavalo pois päältä.		
	bl AU*	Taustavalon automaattinen kytkentä vaa'an käytön yhteydessä.		
<div><div>F5 Str</div><div>Taaran seuranta Jos kyseessä on tyyppihyväksytty laite, toiminto on estetty.</div></div>	Str on	Taaran seuranta kytketty päälle.		
	Str oFF*	Taaran seuranta kytketty pois päältä.		

<div>ECH</div> <div>Huoltovalikko</div>	Pin	Salasanan syöttö: Paina <div>F</div> <div>TARE</div> ja <div>M</div> / <div>BMI</div> .
Paina kalibroitinpainiketta, asento katso 17 luku.		
<div>P1 SPd</div> <div>Lukema-aika</div>	15*	Ei eritelty.
	30	
	60	
	7,5	
<div>P2 CAL</div>	Kalibrointi, katso 18 luku.	
<div>P3 Pro</div>	tri*	Ei eritelty.
	CoUnt	Ei eritelty.
	rSEt	Tehdasasetusten palauttaminen.
	SEtGrA	Ei eritelty.

* Tehdasasetukset

13 RS 232-tiedonsiirtoliitäntä

Valikon asetusten mukaan RS 232 –liitännän avulla tiedot on tulostettavissa

automaattisesti tai painamalla .

Tiedonsiirto tapahtuu asynkronisesti ASCII-koodissa.


Vaa'an ja tulostimen liittämiseksi toisiinsa on täytettävä seuraavat ehdot:

- Vaa'an tulee olla yhdistetty tulostimeen asianmukaisella johdolla. Häiritsemätön käyttö toteutuu ainoastaan KERN:n tiedonsiirtojohdon avulla.
- Vaa'an ja tulostimen viestintäparametrien tulee olla yhteensopivat (tiedonsiirtonopeus, biitit, pariteetti). Lisätietoa viestintäparametreista - katso kohta 13.1.



Sairaanhoitoympäristössä liitäntään voi kytkeä ainoastaan EN 606011 - mukaisia laitteita.

13.1 Vaa'an lähtöliitännän napatoiminnot

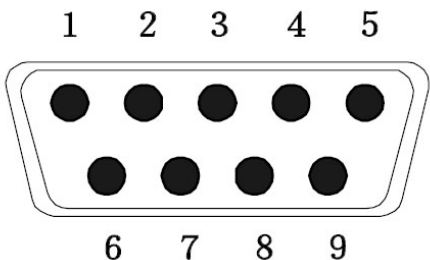	<p>Napa 2: TXD – lähtö Napa 3: RXD – tulo Pin 5: GND – maadoitus</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

13.2 Tekniset tiedot

Liitäntä	9-napainen D-sub-pikkuliitäntä
	Napa 2 – lähtö
	Napa 3 – tulo
	Napa 5 – maadoitus
Tiedonsiirtonopeus	vaihtoehdot 600/1200/2400/4800/9600
Pariteetti	8 biittiä

13.3 Tulostustila

Tuloste-esimerkit:

Prt	
0 / 2	60.0 kg
1 / 3	60.0 kg 170.0cm 20.7BMI

Kauko-ohjauskomennot:

S:

29.03.2017	09:31:21:	ST	20.0kg	vakaa punnitus arvo positiivinen
29.03.2017	09:31:51:	ST	- 20.0kg	vakaa punnitus arvo negatiivinen

W:

29.03.2017	09:32:25:	US	44.3kg	instable punnitus arvo positiivinen
29.03.2017	09:35:33:	US	- 18.4kg	instable punnitus arvo negatiivinen

14 Virheilmoitukset

Lukema

Kuvaus

Err4

Nolla-alueen ylittäminen

(käynnistyessä tai -painiketta painettaessa)

- Punnittu aine sijaitsee vaakalevyllä
- Ylikuormitus vaa'an nollauksen yhteydessä
- Väärä kalibrointi
- Painokennon häiriö

Err6

Arvo on analogi-digitaalimuuntimen alueen ulkopuolella

- Punnituskenno vaurioitunut
- Vaurioitunut elektroniikka

Err 19

Nollapisteen alustus ei onnistunut

- Punnituskenno on vaurioitunut/ylikuormittunut.
- Esineet ovat alustalla ja ottavat siihen kiinni.
- Vaurioitunut emälevy.

Jos näytölle tulee joku muu virheilmoitus, vaaka on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen. Ongelman jatkuessa ota yhteyttä valmistajaan.

15 Huolto, kunnossapito, hävitys

15.1 Puhdistus



Ennen huolto-, puhdistus- ja korjausboiden aloittamista laitteesta on katkaistava virta.

15.2 Puhdistus/desinfiointi

Istuinta ja koteloa on puhdistettava taloudenpitoon tarkoitettulla puhdistusaineella tai yleisellä desinfiointiaineella, esim. 70% isopropanolilla. Suosittelemme käyttämään kosteapyyhkäisyyn tarkoitettua desinfiointiainetta. Noudata valmistajan ohjeita.

Ei saa käyttää hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita, kuten pirtua, bensiiniä tai vastaavia aineita, sillä ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa.

Noudata seuraavia desinfiointi- ja puhdistusvälejä ristitartunnan (sienitauti) välttämiseksi:

- Istuinta on desinfioitava ennen jokaista punnitusta ja sen jälkeen, mikäli siihen liittyy ihokosketus.
- Tarvittaessa:
 - Näyttö
 - Muovinäppäimistö



Ei saa ruiskuttaa laitetta desinfiointiaineella.

Vältä desinfiointiaineen valumista vaa'an sisään.

Laitteen saastuessa puhdistu se välittömästi.

15.3 Sterilointi

Laitteen sterilointi ei ole sallittu.

15.4 Huolto, kunnossapito

Laitteen huoltotöitä saavat suorittaa ainoastaan KERN-yrityksen kouluttamat ja valtuuttamat työntekijät.

Suosittelomme tarkistamaan säännöllisesti vaa'an yhdenmukaisuuden teknisiin turvallisuusvaatimuksiin (STK).

Ennen vaa'an avaamista kytke se ensin irti sähköverkosta.

15.5 Hävitys

Pakkauksen ja laitteen hävitystä on suoritettava laitteen käyttöpaikalla voimassaolevan kansallisen tai alueellisen lainsäädännön mukaisesti.

16 Vianetsintä

Jos punnitusprosessissa esiintyy häiriöitä, vaaka on sammutettava ja katkaistava sähköverkosta. Hetken kuluttua punnitus on aloitettava uudelleen.

Häiriö

Mahdollinen syy

Painon ilmaisin ei pala.

- Vaaka ei ole päällä.
- Katkaistu verkkoyhteys (katkaistu/vaurioitunut virtajohto).
- Syöttöjännitteen puute.
- Akku/Akkut asennettu väärin tai tyhjä.
- Ei akkua/Akkut.

Painoarvo
jatkuvasti.

vaihtelee

- Läpiveto/liikkuva ilma.
- Pöydän/alustan värinä.
- Vaakalevy koske muita esineitä tai se on asennettu väärin.
- Sähkömagneettisia kenttiä/staattisia kuormia (valitse muu asennuspaikka - mahdollisuuksien mukaan sammuta häiriöitä aiheuttava laite)

Punnitustulos on selvästi
väärä.

- Vaaka ei ole nollattu oikein.
- Väärä kalibrointi.
- Kova lämpötilavaihtelu.
- Ei noudatettu lämpenemisaikaa
- Sähkömagneettisia kenttiä/staattisia kuormia (valitse muu asennuspaikka - mahdollisuuksien mukaan sammuta häiriöitä aiheuttava laite)

Jos näytölle tulee joku muu virheilmoitus, vaaka on sammutettava ja käynnistettävä uudelleen. Ongelman jatkuessa ota yhteyttä valmistajaan.

17 Vakaus

Yleistä:

2014/31/EY -direktiivin mukaisesti vaaka on aina vaattava seuraaviin (lainmukaisiin) käyttötarkoituksiin:

- a) kauppapunnitukset, jos tavaran hinta määräytyy punnituksen perusteella;
- b) lääkkeiden tuotanto apteekeissa sekä lääkinnällisissä ja farmaseuttisissa laboratoriotutkimuksissa;
- c) viranomaisten käyttöön;
- d) valmiiden pakkausten tuotanto.
- e) potilaiden painon määrittäminen terveydenhuollossa valvonta-, diagnostiikka- ja hoitotarkoituksiin.

Tarvittaessa ota yhteyttä aluehallintovirastoon.

Vakaushjeet:

Teknisessä erittelyssä vakauskelpoiseksi merkityillä vaailla on EU-laajuinen tyyppihyväksyntä. Mikäli vaakaa on tarkoitus käyttää yllämainitulla laillistusalueella, se on vaattava ja sen vakaus on uudistettava säännöllisesti.

Vaa'an vakauksen päivittäminen tapahtuu kansallisten määräyksien mukaisesti.

Vakauksen voimassaoloaika on annettu kohdassa 17.1.

Noudata kansallisia lainmääräyksiä!




Vakaus ilman sinetöintiä on mitätön.

Jos vaa'alla on tyyppihyväksyntä, sen sinetöinti tarkoittaa, että vaa'an saa avata ainoastaan koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Sinetöinnin poistaminen aiheuttaa vakauksen mitätöinnin. Noudata kansallisia lainmääräyksiä. Saksassa uudelleenvakaus on pakollinen.

Vakauksenalainen vaaka on poistettava käytöstä, mikäli:

- Vaa'an antama **punnitustulos** ylittää **sallitun toleranssiarvon**. Vaaka on tarkastettava säännöllisesti mallipainon avulla (n. 1/3 maksimipainosta) ja verrattava näytettyä arvoa mallipainoon.
- Uudelleenvakauksen **määräaika on ylittynyt**.

Kalibrointipainikkeen ja sinetöinnin asento:

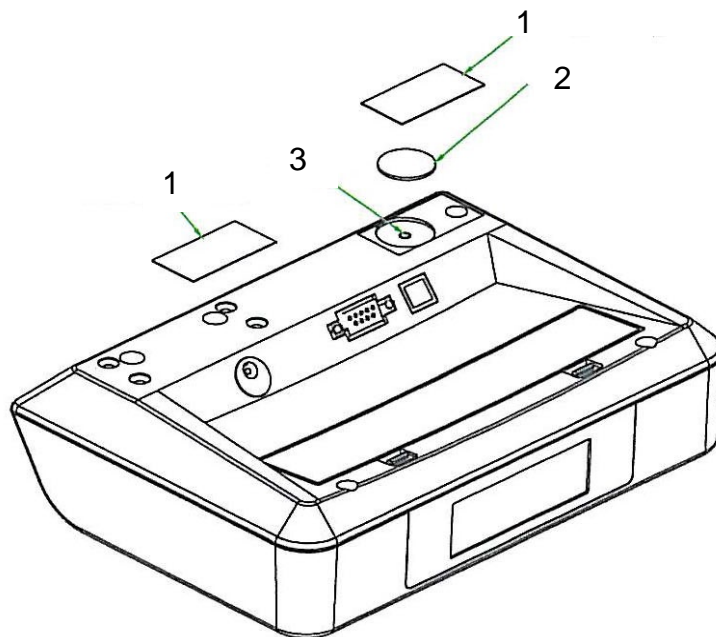

1. Itsetuhoutuva sinetöinti
2. Suojus
3. Kalibrointipainike

17.1 Vakauksen voimassaoloaika (nykytila Saksassa)

Henkilövaa'at (mukaanlukien tuolivarusteiset tai pyörätuolille tarkoitetut vaa'at) sairaaloissa	4 vuotta
Henkilövaa'at - jos käytössä sairaaloiden ulkopuolella (esim. vastaanottohuoneissa ja hoitokodeissa)	toistaiseksi
Vauvavaa'at ja mekaaniset vaa'at vastasyntyneille lapsille	4 vuotta
Sänkyvaa'at	2 vuotta
Vaaka dialyysiasemiin	toistaiseksi


Sairaaloihin kuuluvat myös kuntoutusklinitkat ja osastot (vakauksen voimassaolo 4 vuotta).


Dialyysiasemia, hoitokoteja ja vastaanottohuoneita ei katsota sairaalaksi (hyväksyntä voimassa toistaiseksi).

("Hyväksyntäviraston tiedotus: lääkinälliset vaa'at" -asiakirjan mukaan)






18 Kalibrointi




















Koska painovoiman kiihtyvyys ei ole sama joka paikassa maapallolla, fysiikan peruslainalaisuuksiin perustuvan jokainen näyttö ja siihen liitetty vaakalevy on mukautettava sen käyttöpaikan mukaiseen gravitaatiokiihtyvyyteen (ellei punnitusjärjestelmä ole jo kalibroitu tehtaalla tulevan käyttöpaikan olosuhteet huomioiden). Kalibrointi on suoritettava käyttöönoton yhteydessä, vaa'an käyttöpaikan vaihtuessa sekä ympäristölämpötilan vaihdellessa. Mittaustarkkuuden varmistamiseksi suositellaan kalibroimaan näytön ajoittain punnitustilassa.




	<ul style="list-style-type: none"> Valmista tarvittava kalibrointipaino. Käytettävä kalibrointipaino on vaa'an punnitusalueen mukainen - katso 1 luku. Mahdollisuuksien mukaan kalibrointi on suoritettava vaa'an maksimipainoa lähellä olevalla painolla. Lisätiedot mallipainoista löytyvät osoitteesta: http://www.kern-sohn.com. Varmista pysyvät ympäristöolosuhteet. Varmista tarvittava lämpenemisaika vaa'an stabilointia varten - katso luku 1.
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Lainmukaisten vaakojen osalta pääsy "tCH"-huoltovalikkoon on estetty. Lukituksen poistamiseksi sinetöinti on poistettava ja painettava kalibrointipainiketta. Kalibrointipainikkeen sijainti - katso 17 luku.</p> <p>Huom: Sinetöinnin poiston jälkeen ja ennen punnitusjärjestelmän käyttöä lainmukaisiin tarkoituksiin se on vaattava uudelleen pätevän hyväksyntälaitoksen kanssa ja sinetöitävä uudelleen.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalibrointimenetelmä:

 <p>↓</p> 	<p>⇒ Punnitustilassa paina pari kertaa -painiketta, kunnes "tCH"-valikko ilmestyy.</p>
	<p>⇒ Paina , jolloin näytöltä ilmenee "Pin"-toiminto.</p>

	Paina  ,  ja  /  -painiketta, jolloin [P1 SPd] -toiminto ilmestyy.
 ↓ 	⇒ Paina  -painiketta, jolloin [P2 CAL] -toiminto ilmestyy. ⇒ Paina kalibrointipainiketta, asento katso 17 luku.
	⇒ Paina  , jolloin "dESC" -toiminto ilmestyy.
	⇒ Paina pari kertaa  -painiketta, kunnes [CAL] -toiminto ilmestyy. ⇒ Vahvista asetus painamalla  , jolloin näytölle tulee "UloAd" .
	⇒ Vaakalevyllä ei saa jättää mitään esineitä. ⇒ Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy ja vahvista painamalla  .
 (esimerkki)	⇒ Näytöltä näkyy asetetun kalibrointipainon arvo. Tarvittaessa voit valita muutettava elementti  -painikkeella ja muuttaa arvoa  -painikkeella. ⇒ Vahvista asetus painamalla  , jolloin näytölle tulee "LoAd" .

	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Aseta kalibrointipaino vaakalevyn keskelle. ⇒ Odota, kunnes STABLE-stabilointimerkki syttyy. ⇒ Vahivsta asetus painamalla , jolloin näytölle tulee "PASS".
	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Vaaka suorittaa itsetarkistuksen. Näytölle tulee [Err19] ja laite antaa yhden merkkiäänän. ⇒ Sammuta vaaka. ⇒ Poista kalibrointipaino. ⇒ Kytke vaaka uudelleen päälle ja itsetarkistuksen jälkeen vaaka siirtyy punnitustilaan. Kalibrointi on suoritettu loppuun.